

IT - Largo & Gates

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Largo & Gates sono frese in acciaio inox per canali radicolari.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per l'allargamento dei canali radicolari.

Misure

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Confezionamento

Dispositivo non sterile in blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure).

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

- Utilizzare in qualsiasi manipolo ad angolo retto per allargare la porzione coronale del canale per la rimozione massiva della struttura.
- Durante la sequenza endodontica, irrigare ripetutamente con ipoclorito (Endo Clor) e E.D.T.A. (Canal Prep) al fine di eliminare tutto il tessuto necrotico e la componente organica del fango dentinale.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, al riparo da umidità e lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

Prima dell'uso, si raccomanda di verificare con i

pazienti l'eventuale allergia alle materie prime.

Si raccomanda di utilizzare sempre guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazione batterica. La mancata osservanza di questa regola può comportare infezioni crociate.

Avvertenze

- Dispositivo monouso, non è consigliato il riutilizzo per limitare i problemi legati alle infezioni crociate e/o alle fratture.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.
- Non forzare mai lo strumento nel canale.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Controindicazioni

Non utilizzare in pazienti con sensibilità allergica nota alle materie prime.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EN - Largo & Gates

Mechanical root canal instruments

Description

Largo & Gates are stainless steel burs for root canals.

Indications

Only to be used in dental practices or in hospitals by qualified personnel.

Field of application

For enlarging root canals.

Measures

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Packaging

Non-sterile device in blister pack of 6 pieces (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operating protocol:

- Use in any right angle handpiece to widen the coronal portion of the canal for the massive removal of structure.
- During the endodontic sequence, repeatedly irrigate with hypochlorite (Endo Clor) and E.D.T.A. (Canal Prep) to remove all necrotic tissue and the organic component of the dentinal slurry.

Storage

Store at room temperature, away from moisture and direct light.

Precautions

Before use, it is recommended to check with patients

for any allergy to raw materials.

It is recommended to always use surgical gloves for personal protection against bacterial contamination. Failure to do so may result in cross-infection.


Warnings

- Single-use device, re-use is not recommended to limit problems with cross-infection and/or breakage.
- Do not use the blister if opened or damaged.
- Never force the instrument into the canal.
- Do not use after the indicated expiry date.
- You must report any serious incidents occurring in relation to the medical device we have supplied to the manufacturer and to the competent authority in your Member State.

Contraindications

Do not use in patients with known allergic sensitivity to raw materials.

Symbols

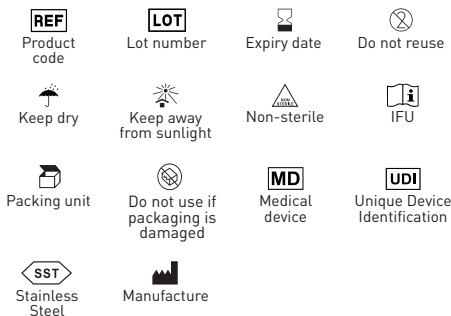

Warranty

Dental World shall replace the product if it proves to be defective.

Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, resulting from careless use or inability to use the product described. Before use, it is the user's responsibility to determine the appropriateness of the product for its use. The user assumes responsibility for use careless use.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

FR - Largo & Gates

Instruments mécaniques pour le traitement du canal radiculaire

Description

Largo & Gates sont des fraises en acier inoxydable pour les canaux radiculaires.

Indications

A utiliser uniquement dans les cabinets dentaires ou dans les hôpitaux par du personnel qualifié.

Domaine d'application

Pour l'élargissement des canaux radiculaires.

Mesures

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Conditionnement

Dispositif non stérile sous blister de 6 pièces (assorties ou de tailles individuelles).

Procédure recommandée

Protocole opératoire:

- Utiliser dans n'importe quelle pièce à main à angle droit pour élargir la partie coronaire du canal pour l'élimination massive de la structure.
- Pendant la séquence endodontique, irriguer à plusieurs reprises avec de l'hypochlorite (Endo Clor) et de l'E.D.T.A. (Canal Prep) pour éliminer tous les tissus nécrotiques et les composants organiques de la boue dentinaire.

Stockage

Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe.

Précautions d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de vérifier avec les patients s'il n'y a pas d'allergie aux matières premières.

Il est recommandé de toujours utiliser des gants chirurgicaux pour se protéger contre la contamination bactérienne. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une infection croisée.


Avertissements

- Dispositif à usage unique, la réutilisation n'est pas recommandée pour limiter les problèmes d'infection croisée et/ou de rupture.
- Ne pas utiliser le blister s'il est ouvert ou endommagé.
- Ne jamais forcer l'instrument dans le canal.
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.
- Vous devez signaler au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre tout incident grave lié au dispositif médical que nous avons fourni.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité allergique connue aux matières premières.

Symboles

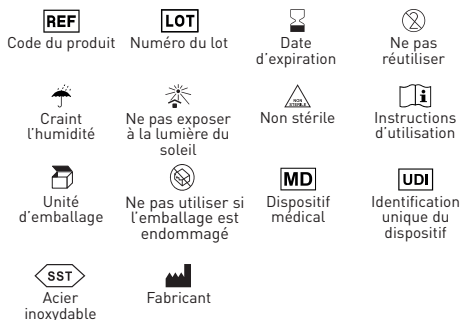

Garantie

Dental World remplacera le produit s'il s'avère défectueux.

Dental World n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct ou consécutif, résultant de l'utilisation négligente ou de l'incapacité d'utiliser le produit décrit. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à son utilisation. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation négligente.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ES - Largo & Gates

Instrumentos mecánicos para conductos radiculares

Descripción

Largo & Gates son fresas de acero inoxidable para conductos radiculares.

Indicaciones

Sólo para ser utilizadas en una consulta dental o en un entorno hospitalario por personal cualificado.

Campo de aplicación

Para la ampliación de conductos radiculares.

Medidas

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Sur. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Sur. n°1 - 6	144910007	144910014

Envase

Dispositivo no estéril en blister de 6 piezas (tamaños surtidos o individuales).

Procedimiento recomendado

Protocolo operativo:

- Utilizar en cualquier pieza de mano de ángulo recto para ensanchar la porción coronal del conducto para la eliminación masiva de estructura.
- Durante la secuencia endodóntica, irrigar repetidamente con hipoclorito (Endo Clor) y E.D.T.A. (Canal Prep) para eliminar todo el tejido necrótico y el componente orgánico de la lechada dental.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa.

Precauciones

Antes de su uso, se recomienda comprobar con los pacientes cualquier alergia a las materias primas. Se recomienda utilizar siempre guantes quirúrgicos para la protección personal contra la contaminación bacteriana. De lo contrario, pueden producirse infecciones cruzadas.

Advertencias

- Dispositivo de un solo uso, no se recomienda su reutilización para limitar los problemas de infección cruzada y/o rotura.
- No utilizar el blister si está abierto o dañado.
- No forzar nunca el instrumento en el canal.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada.
- Debe informar al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario que ha suministrado.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con sensibilidad alérgica conocida a las materias primas.

Símbolos



Garantía

Dental World sustituirá el producto si resulta defectuoso.

Dental World no se hace responsable de los daños o pérdidas, directos o indirectos, resultantes de un uso descuidado o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Antes de su uso, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso. El usuario asume la responsabilidad por el uso descuidado.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

BG - Largo & Gates

Механични инструменти за коренови канали

Описание

Largo & Gates са борчета от нерждаема стомана за коренови канали.

Показания

Да се използват само в стоматологична практика или в болнична среда от квалифициран персонал.

Област на приложение

За разширяване на коренови канали.

Мерки

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Асо. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Асо. n°1 - 6	144910007	144910014

Опаковка

Нестерилно устройство в блистерна опаковка от 6 броя (асортимент или индивидуални размери).

Препоръчителна процедура

Протокол за работа:

- Използвайте във всеки правоъгълен наконечник за разширяване на коронарната част на канала за масивно отстраняване на структурата.
- По време на ендодонтската последователност иригирайте многократно с хипохлорит (Endo Clor) и E.D.T.A. (Canal Prep), за да отстраните цялата некротична тъкан и органичния компонент на дентиновата каша.

Съхранение

Съхранявайте при стайна температура, далеч от влага и пряка светлина.

Предпазни мерки

Преди употреба се препоръчва да се провери при

пациентите за евентуална алергия към суровините. Препоръчва се винаги да се използват хирургически ръкавици за лична защита срещу бактериално замърсяване. Ако не го направите, това може да доведе до кръстосано заразяване.

Предупреждения

- Устройство за еднократна употреба, не се препоръчва повторна употреба, за да се ограничи проблемите с кръстосана инфекция и/или счупване.
- Не използвайте блистера, ако е отворен или повреден.
- Никога не вкарвайте инструмента в канала със сила.
- Не използвайте след посочения срок на годност.
- Трябва да съобщавате за всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с доставеното от вас медицинско изделие, на производителя и на компетентния орган във вашата държава членка.

Противопоказания

Да не се използва при пациенти с известна алергична чувствителност към суровини.

Символи



Гаранция

Dental World заменя продукта, ако се окаже, че той е дефектен.

Dental World не поема отговорност за каквито и да било преки или последващи щети или загуби, произтичащи от небрежна употреба или невъзможност за използване на описания продукт. Преди употреба потребителят носи отговорност за това, че да определи доколко продуктът е подходящ за неговата употреба. Потребителят поема отговорност за използването на небрежна употреба.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it



HR - Largo & Gates

Mehanički instrumenti za korijenske kanale

Opis

Largo & Gates su svrdla od nehrdajućeg čelika za korijenske kanale.

Upute

Koristiti ga samo u stomatološkoj ordinaciji ili bolničkom okruženju od strane kvalificiranog osoblja.

Područje primjene

Za proširenje korijenskih kanala.

Mjere

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Raz. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Raz. n°1 - 6	144910007	144910014

Ambalaža

Nesterilni uređaj u blister pakiranju od 6 komada (razne ili pojedinačne veličine).

Preporučeni postupak

Radni protokol:

- Koristite u bilo kojem nasadniku pod pravim kutom za proširenje koronarnog dijela kanala za masovno uklanjanje strukture.
- Tijekom endodontskog slijeda, više puta irigirajte hipokloritom (Endo Clor) i E.D.T.A. (Canal Prep) kako bi se uklonilo svo nekrotično tkivo i organska komponenta razmaznog sloja.

Skладиštenje

Čuvati na sobnoj temperaturi, daleko od vlage i izravnih izvora svjetlosti.

Mjere predostrožnosti

Prije uporabe preporuča se provjeriti s pacijentima moguće alergije na sirovine.

Preporuča se uvijek koristiti kirurške rukavice za individualnu zaštitu od bakterijske kontaminacije. Nepoštivanje ovog pravila može dovesti do unakrsne infekcije.


Upozorenja

- Uređaj za jednokratnu upotrebu, ne preporučuje se ponovna uporaba kako bi se ograničili problemi povezani s unakrsnim infekcijama i/ili lomovima.
- Nemojte koristiti blister ako je otvoren ili oštećen.
- Nikada ne silite turpiju u kanal.
- Nemojte koristiti nakon isteka navedenog roka valjanosti.
- Morate prijaviti svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s medicinskim uređajem koji smo isporučili proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazite.

Kontraindikacije

Ne koristiti u bolesnika s poznatom alergijskom osjetljivošću na sirovine.

Simboli

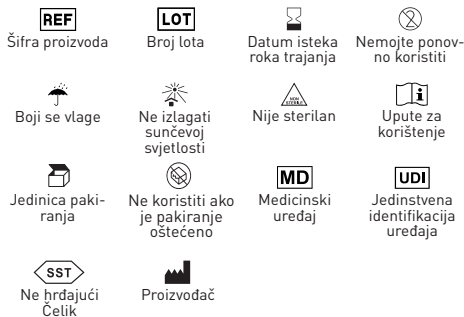

Jamstvo

Dental World će zamijeniti proizvod koji se pokaže neispravnim.

Dental World ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravni ili posljedični koji proizlaze iz nemara ili nemogućnosti korištenja opisanog proizvoda. Korisnik je prije uporabe odgovoran utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu ili njezinu upotrebu. Korisnik preuzima odgovornost za nepažljivo korištenje.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

CS - Largo & Gates

Mechanické nástroje pro kořenové kanálky

Popis

Largo & Gates jsou bury z nerezové oceli pro kořenové kanálky.

Indikace

Pouze k použití v zubních ordinacích nebo v nemocnicích kvalifikovaným personálem.

Oblast použití

K rozšiřování kořenových kanálků.

Míry

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Sor. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Sor. n°1 - 6	144910007	144910014

Balení

Nesterilní zařízení v blistrech po 6 kusech (různé nebo jednotlivé velikosti).

Doporučený postup

Provozní protokol:

- Použijte v jakémkoli pravouhlém násadci k rozšíření koronální části kanálku pro masivní odstranění struktury.
- Během endodontické sekvence opakovaně irigujte chlornanem (Endo Clor) a E.D.T.A. (Canal Prep), abyste odstranili veškerou nekrotickou tkáň a organickou složku dentinové kaše.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah vlhkosti a přímého světla.

Bezpečnostní opatření

Před použitím doporučujeme u pacientů ověřit případnou alergii na suroviny.

Doporučuje se vždy používat chirurgické rukavice pro osobní ochranu před bakteriální kontaminací. V opačném případě může dojít ke křížové infekci.

Upozornění

- Pomůcka na jedno použití, opakované použití se nedoporučuje, aby se omezily problémy s křížovou infekcí a/nebo rozbitím.
- Nepoužívejte otevřený nebo poškozený blister.
- Nikdy nezasouvejte nástroj do kanálku násilím.
- Nepoužívejte po uvedeném datu spotřeby.
- Veškeré závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s dodaným zdravotnickým prostředkem, musíte hlásit výrobci a příslušnému orgánu ve vašem členském státě.

Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů se známou alergickou citlivostí na suroviny.

Symbols



Kód produktu



Číslo šarže



Datum expirace



Nepoužívat opakovaně



Obavy z vlhkosti



Nevystavujte slunečnímu záření



Ne sterilní



Návod k použití



Balící jednotka



Nepoužívejte, pokud je obal poškozen



Zdravotnický prostředek



Jedinečná identifikace prostředku



Nerezová ocel



Výrobce

Záruka

Společnost Dental World vymění výrobek, pokud se ukáže, že je vadný.

Společnost Dental World nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vzniklé v důsledku neopatrného používání nebo nemožnosti používat popsany výrobek. Před použitím je povinností uživatele zjistit vhodnost výrobku pro jeho použití. Uživatel přebírá odpovědnost za neopatrné použití.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DA - Largo & Gates

Mekaniske rodkanalinstrumenter

Beskrivelse

Largo & Gates er boremaskiner i rustfrit stål til rodkanaler.

Indikationer

Må kun anvendes i en tandlægepraksis eller på et hospital af kvalificeret personale.

Anvendelsesområde

Til udvidelse af rodkanaler.

Mål

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Emballage

Ikke-steril anordning i blisterpakning med 6 stk. (assorterede eller individuelle størrelser).

Anbefalet fremgangsmåde

Operationsprotokol:

- Anvendes i ethvert vinkelhåndstykke til udvidelse af den koronale del af kanalen til massiv fjernelse af struktur.
- Under den endodontiske sekvens skal der gentagne gange spules med hypoklorit (Endo Clor) og E.D.T.A. (Canal Prep) for at fjerne alt nekrotisk væv og den organiske komponent i dentinal opløsning.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur, væk fra fugt og direkte lys.

Forholdsregler

Før brug anbefales det at undersøge patienterne for

eventuel allergi over for råmaterialer.

Det anbefales altid at bruge kirurgiske handsker til personlig beskyttelse mod bakteriel kontaminering. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre krydssmitte.


Advarsler

- Engangsanordning, genbrug anbefales ikke for at begrænse problemer med krydssmitte og/eller brud.
- Blisteren må ikke anvendes, hvis den er åbnet eller beskadiget.
- Tving aldrig instrumentet ind i kanalen.
- Må ikke anvendes efter den angivne udløbsdato.
- Du skal indberette alle alvorlige hændelser i forbindelse med det medicinske udstyr, som du har leveret, til producenten og til den kompetente myndighed i din medlemsstat.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til patienter med kendt allergisk overfølsomhed over for råmaterialer.

Symboler

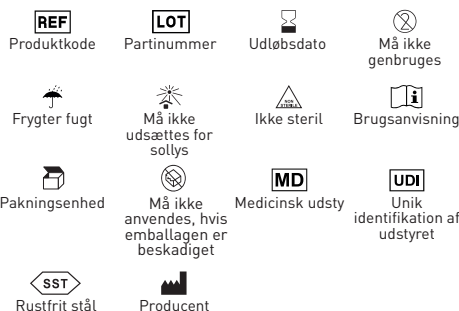

Garanti

Dental World erstatter produktet, hvis det viser sig at være defekt.

Dental World påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, som skyldes uforsigtig brug eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet til den pågældende anvendelse. Brugeren påtager sig ansvaret for uforsigtig brug.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

NL - Largo & Gates

Mechanische wortelkanaalinstrumenten

Beschrijving

Largo & Gates zijn roestvrijstalen boren voor wortelkanalen.

Indicaties

Alleen te gebruiken in een tandartspraktijk of ziekenhuisomgeving door gekwalificeerd personeel.

Toepassingsgebied

Voor het vergroten van wortelkanalen.

Maatregelen

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Verpakking

Niet-steriel apparaat in blisterverpakking van 6 stuks (assorti of individuele maten).

Aanbevolen procedure

Operatieprotocol:

- Gebruik in elk rechthoekig handstuk om het coronale deel van het kanaal te verbreden voor de massale verwijdering van de structuur.
- Tijdens de endodontische procedure herhaaldelijk irrigeren met hypochloriet (Endo Clor) en E.D.T.A. (Canal Prep) om alle necrotisch weefsel en de organische component van de dentinale slurry te verwijderen.

Opslag

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en direct licht.

Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aanbevolen om vóór gebruik bij de patiënt na

te gaan of er sprake is van allergie voor grondstoffen. Het wordt aanbevolen altijd chirurgische handschoenen te gebruiken voor persoonlijke bescherming tegen bacteriële besmetting. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot kruisbesmetting.


Waarschuwingen

- Hulpmiddel voor eenmalig gebruik, hergebruik wordt afgeraden om problemen met kruisbesmetting en/of breuk te beperken.
- Gebruik de blisterverpakking niet als deze geopend of beschadigd is.
- Forceer het instrument nooit in het kanaal.
- Niet gebruiken na de aangegeven vervaldatum.
- U moet ernstige incidenten in verband met het door u geleverde medische hulpmiddel melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit in uw lidstaat.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij patiënten met bekende allergische gevoeligheid voor grondstoffen.

Symbolen

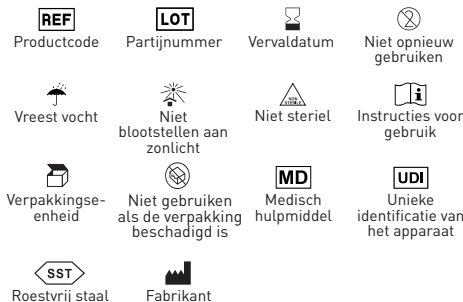

Garantie

Dental World vervangt het product als het defect blijkt te zijn.

Dental World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet kunnen gebruiken van het beschreven product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik vast te stellen of het product geschikt is voor zijn gebruik. De gebruiker is aansprakelijk voor onzorgvuldig gebruik.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

ET - Largo & Gates

Mehhaanilised juurekanalite instrumendid

Kirjeldus

Largo & Gates on roostevaba terasest freespuurid juurekanalite jaoks.

Näidustused

Kasutatakse ainult hambaravipraksistes või haiglates kvalifitseeritud personali poolt.

Kasutusala

Juurekanalite laiendamiseks.

Meetmed

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Sor. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Sor. n°1 - 6	144910007	144910014

Pakend

Mittesteriilne seade blisterpakendis, milles on 6 tükki (sorteeritud või individuaalses suurus).

Soovitatav protseduur

Operatsiooniprotokoll:

- Kasutage mis tahes täisnurga käsiseadmega kanali koronaalse osa laiendamiseks massiivse struktuuri eemaldamiseks.
- Endodontilise järjestuse ajal loputage korduvalt hüpokloriidi (Endo Clor) ja E.D.T.A. (Canal Prep) abil, et eemaldada kogu nekrootiline kude ja dentiinipuru orgaaniline komponent.

Säilitamine

Säilitada toatemperatuuril, niiskuse ja otsese valguse eest kaitstult.

Ettevaatusabinõud

Enne kasutamist on soovitatav kontrollida patsiendi võimalikku allergiat tooraine suhtes.

Isikliku kaitse tagamiseks bakteriaalse saastumise eest on soovitatav alati kasutada kirurgilisi kindaid. Vastasel juhul võib tekkida ristnakkus.


Hoiatused

- Ühekordselt kasutatav seade, korduvkasutamine ei ole soovitatav, et piirata ristnakkuse ja/või purunemisega seotud probleeme.
- Ärge kasutage blisterit, kui see on avatud või kahjustatud.
- Ärge kunagi suruge instrumenti jõuga kanalisse.
- Mitte kasutada pärast märgitud kõlblikkusaega.
- Te peate teatama kõigist teie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja oma liikmesriigi pädevale asutusele.

Vastunäidustused

Mitte kasutada patsientidel, kellel on teadaolevalt allergiline tundlikkus toorainete suhtes.

Sümbolid

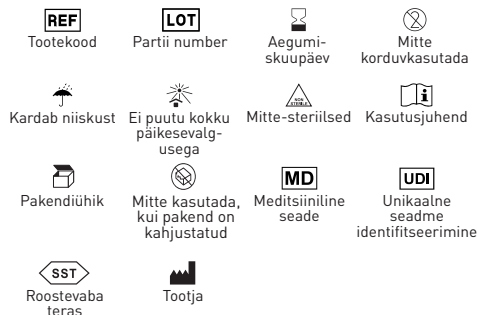

Garantii

Dental World vahetab toote välja, kui see osutub defektseks.

Dental World ei võta vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb kirjeldatud toote hooletust kasutamisest või mittekasutamisest. Enne kasutamist peab kasutaja ise kindlaks tegema, kas toode on tema jaoks sobiv. Kasutaja võtab vastutuse hooletu kasutamise eest.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

DE - Largo & Gates

Mechanische Wurzelkanalinstrumente

Beschreibung

Largo & Gates sind Bohrer aus rostfreiem Stahl für Wurzelkanäle.

Indikationen

Darf nur von qualifiziertem Personal in einer Zahnarztpraxis oder einem Krankenhaus verwendet werden.

Anwendungsbereich

Zum Erweitern von Wurzelkanälen.

Maße

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Verpackung

Unsteriles Gerät in Blisterpackung zu 6 Stück (sortiert oder individuelle Größen).

Empfohlene Vorgehensweise

Arbeitsprotokoll:

- Verwendung in jedem rechtwinkligen Handstück zur Erweiterung des koronalen Teils des Kanals für die massiven Entfernung der Struktur.
- Während der endodontischen Sequenz wiederholt mit Hypochlorit (Endo Clor) und E.D.T.A. (Canal Prep) spülen, um alles nekrotische Gewebe und die organische Komponente des Dentinschlammes zu entfernen.

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und direktem Licht geschützt lagern.

Vorsichtsmaßnahmen

Es wird empfohlen, den Patienten vor der Anwendung auf eine eventuelle Allergie gegen die Rohstoffe zu

untersuchen.

Es wird empfohlen, zum persönlichen Schutz vor bakterieller Kontamination stets chirurgische Handschuhe zu tragen. Andernfalls kann es zu Kreuzinfektionen kommen.


Warnhinweise

- Einwegprodukt, Wiederverwendung wird nicht empfohlen, um Probleme mit Kreuzinfektionen und/oder Bruch zu vermeiden.
- Den Blister nicht verwenden, wenn er geöffnet oder beschädigt ist.
- Das Instrument niemals mit Gewalt in den Kanal einführen.
- Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Sie müssen alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem von Ihnen gelieferten Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats melden.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffen.

Symbole

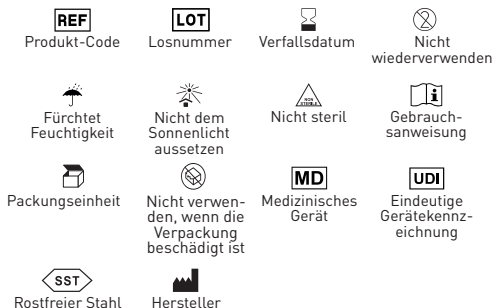

Garantie

Dental World tauscht das Produkt aus, wenn es sich als fehlerhaft erweist.

Dental World haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich ergeben aus oder der Unfähigkeit, das beschriebene Produkt zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch die Eignung des Produkts für seine Verwendung festzustellen. Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für die vorsichtige Verwendung.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

EL - Largo & Gates

Μηχανικά εργαλεία απονεύρωσης

Περιγραφή

Τα Largo & Gates είναι κοπτικά από ανοξείδωτο χάλυβα για ριζικούς σωλήνες.

Ενδείξεις

Να χρησιμοποιούνται μόνο σε οδοντιατρείο ή νοσοκομειακό περιβάλλον από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πεδίο εφαρμογής

Για τη διεύρυνση των ριζικών σωλήνων.

Μέτρα

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ποι. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ποι. n°1 - 6	144910007	144910014

Συσκευασία

Μη αποστειρωμένη συσκευή σε συσκευασία blister των 6 τεμαχίων (διαλεγμένα ή μεμονωμένα μεγέθη).

Συνιστώμενη διαδικασία

Πρωτόκολλο λειτουργίας:

- Χρήση σε οποιοδήποτε χειρολαβή ορθής γωνίας για τη διεύρυνση του στεφανιαίου τμήματος του σωλήνα για την
- μαζική σφαίρεση της δομής.
- Κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής ακολουθίας, ξεπλύνετε επανειλημμένα με υποχλωριώδες (Endo Clor) και E.D.T.A. (Canal Prep) για να απομακρύνετε όλους τους νεκρωτικούς ιστούς και το οργανικό συστατικό του οδοντικού πολτού.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από την υγρασία και το άμεσο φως.

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση, συνιστάται να ελέγχεται με τους ασθενείς για τυχόν αλλεργία στις πρώτες ύλες.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα χειρουργικά γάντια

για προσωπική προστασία από βακτηριακή μόλυνση. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη λοίμωξη.


Προειδοποιήσεις

- Συσκεύη μιας χρήσης, δεν συνιστάται επαναχρησιμοποίηση για τον περιορισμό των προβλημάτων διασταυρούμενης μόλυνσης ή/και θραύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε την κυψέλη εάν έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
- Ποτέ μην πιέζετε το όργανο με δύναμη μέσα στο κανάλι.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
- Πρέπει να αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχετε προμηθεύσει.

Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή αλλεργική ευαισθησία στις πρώτες ύλες.

Σύμβολα

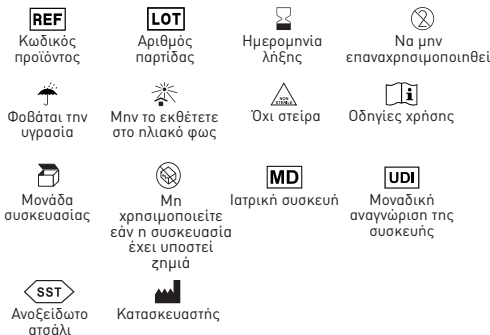

Εγγύηση

Dental World αντικαθιστά το προϊόν εάν αποδειχθεί ελαττωματικό.

Dental World δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκύπτει από.

απρόσεκτη χρήση ή αδυναμία χρήσης του περιγραφόμενου προϊόντος. Πριν από τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη.

να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για τη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση απρόσεκτη χρήση.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

HU -Largo & Gates

Mechanikus gyökérkezelő műszerek

Leírás

A Largo & Gates rozsdamentes acélból készült fúróeszközök gyökércsatornákhoz.

Indikációk

Kizárólag fogorvosi rendelőben vagy kórházi környezetben, szakképzett személyzet által használható.

Alkalmazási terület

Gyökércsatornák bővítéséhez.

Méretek

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Vál. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Vál. n°1 - 6	144910007	144910014

Csomagolás

Nem steril eszköz 6 darabos buborékcsomagolásban (válogatott vagy egyedi méretben).

Ajánlott eljárás

Működési protokoll:

- Használja bármely derékszögű kéziszerszámban a csatorna koronális részének kiszélesítéséhez a struktúra masszív eltávolításához.
- Az endodontiai szekvencia során ismételtlen öblítse ki hipoklorit (Endo Clor) és E.D.T.A. (Canal Prep) segítségével, hogy eltávolítsa az összes nekrotikus szövetet és a dentinaliszap szerves komponensét.

Tárolás

Szobahőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen fénytől védve tárolandó.

Övintézkedések

Használat előtt ajánlott ellenőrizni a betegekkel, hogy nem allergiásak-e a nyersanyagokra.

A bakteriális szennyeződés elleni személyes védelem érdekében mindig sebészeti kesztyű használata ajánlott. Ennek elmulasztása keresztfertőzést eredményezhet.

Figyelmeztetések

- Egyszer használatos eszköz, újrafelhasználása nem ajánlott a keresztfertőzéssel és/vagy töréssel kapcsolatos problémák korlátozása érdekében.
- Ne használja a buborékcsomagolást, ha az felnyílt vagy sérült.
- Soha ne erőltesse az eszközt a csatornába.
- Ne használja a feltüntetett lejáratú idő után.
- Az Ön által szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket jelentenie kell a gyártónak és az Ön tagállamának illetékes hatóságának.

Ellenjavallatok

Ne használja olyan betegeknél, akiknél ismert allergiás érzékenység áll fenn a nyersanyagokkal szemben.

Szimbólumok



Garancia

A Dental World kicseréli a terméket, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Motfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LV - Largo & Gates

Mehāniskie sakņu kanālu instrumenti

Apraksts

Largo & Gates ir nerūsējošā tērauda buri sakņu kanālu ārstēšanai.

Indikācijas

Lieto tikai kvalificēts personāls zobārstniecības praksēs vai slimnīcās.

Piemērošanas joma

Sakņu kanālu paplašināšanai.

Pasākumi

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Aso. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Aso. n°1 - 6	144910007	144910014

Iepakojums

Nesterilas ierīces blistera iepakojumā ar 6 gabaliem (dažādi vai atsevišķi izmēri).

Ieteicamā procedūra

Darba protokols:

- Lietošana ar jebkuru taisnā leņķa rokturi, lai paplašinātu kanāla vainagveida daļu, lai masīvai struktūras noņemšanai.
- Endodontiskās sekvenses laikā atkārtoti irigējiet ar hipohlorītu (Endo Clor) un E.D.T.A. (Canal Prep), lai noņemtu visus nekrotiskos audus un dentinālo suspensiju organisko komponentu.

Uzglabāšana

Uzglabāt istabas temperatūrā, pasargāt no mitruma un tiešas gaismas.

Piesardzības pasākumi

Pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt pacientiem, vai nav alerģijas pret izejvielām.

Personiskajai aizsardzībai pret bakteriālu piesārņojumu ieteicams vienmēr lietot ķirurģiskos cimdus. Ja tas netiek darīts, var rasties krusteniskā infekcija.


Brīdinājumi

- Vienreizējās lietošanas ierīce, atkārtota lietošana nav ieteicama, lai ierobežotu krusteniskās infekcijas un/vai bojājumu problēmas.
- Nelietojiet blisteri, ja tas ir atvērts vai bojāts.
- Nekad neiespiediet instrumentu kanālā ar spēku.
- Nelietojiet pēc norādītā derīguma termiņa beigām.
- Jums ir jāziņo ražotājam un dalībvalsts kompetentajai iestādei par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar jūsu piegādāto medicīnas ierīci.

Kontraindikācijas

Nelietot pacientiem ar zināmu alerģisku jutību pret izejvielām.

Simboli

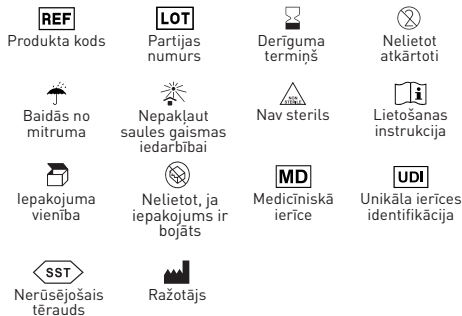

Garantija

Dental World nomaina izstrādājumu, ja tas izrādās bojāts.

Dental World neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies aprakstītā izstrādājuma neuzmanīgas lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Pirms lietošanas lietotājs ir atbildīgs par to, lai noteiktu, vai izstrādājums ir piemērots tā lietošanai. Lietotājs uzņemas atbildību par neuzmanīgu lietošanu.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

LT - Largo & Gates

Mechaniniai šakny kanalų instrumentai

Aprašymas

Largo & Gates™ - tai nerūdijančio plieno frezos šakny kanalams.

Indikacijos

Gali būti naudojami tik kvalifikuoto personalo odontologinėje praktikoje arba liginėje.

Taikymo sritis

Šakny kanalams plėsti.

Priemonės

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Aso. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Aso. n°1 - 6	144910007	144910014

Pakuotė

Nesterilus prietaisas lizdinėje plokštelėje po 6 vienetus (įvairių arba atskirų dydžių).

Rekomenduojama procedūra

Darbo protokolas:

- Naudokite bet kokį stačiakampį antgalį, kad praplėstumėte vainikinę kanalo dalį masyviam struktūros pašalinimui.
- Endodontinės procedūros metu pakartotinai iriguokite hipochloritu („Endo Clor“) ir E.D.T.A. (Canal Prep), kad pašalintumėte visus nekrozinius audinius ir organinį dentino suspensijos komponentą.

Laikymas

Laikyti kambario temperatūroje, saugoti nuo drėgmės ir tiesioginės šviesos.

Atsargumo priemonės

Prieš vartojimą rekomenduojama pasitikrinti, ar pacientai nėra alergiški žaliavoms.

Rekomenduojama visada mūvėti chirurgines pirštines,

kad asmeniškai apsisaugotumėte nuo bakterinio užteršimo. To nepadarius, galima kryžminė infekcija.


Jspėjimai

- Vienkartinis prietaisas, pakartotinai naudoti nerekomenduojama, kad būtų apribotos kryžminės infekcijos ir (arba) gedimo problemos.
- Nenaudokite atidarytos ar pažeistos lizdinės plokštelės.
- Niekada neikiškite instrumento į kanalą jėga.
- Nenaudokite pasibaigus nurodytam galiojimo laikui.
- Apie bet kokius rimtus incidentus, susijusius su jūsų pateiktu medicinos prietaisu, privalote pranešti gamintojui ir savo valstybės narės kompetentingai institucijai.

Kontraindikacijos

Nenaudoti pacientams, kuriems žinomas alerginis jautrumas žaliavoms.

Simboliai

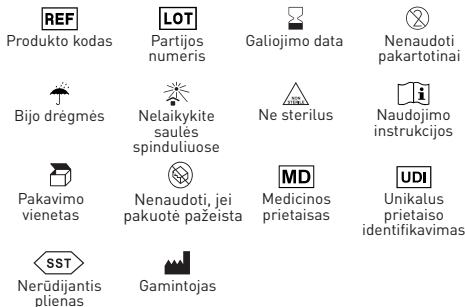

Garancija

A Dental World kicserėli a termékét, ha az hibásnak bizonyul.

A Dental World nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetkezményes kárért vagy veszteségért, amely a leírt termék gondatlan használatából vagy használhatatlanságából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra. A gondatlan használatért a felhasználó vállalja a felelősséget.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PL - Largo & Gates

Mechaniczne instrumenty do kanałów korzeniowych

Opis

Largo & Gates to wiertła ze stali nierdzewnej do kanałów korzeniowych.

Wskazania

Do stosowania wyłącznie w gabinetach stomatologicznych lub w szpitalach przez wykwalifikowany personel.

Zakres zastosowania

Do poszerzania kanałów korzeniowych.

Miary

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Aso. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Aso. n°1 - 6	144910007	144910014

Opakowanie

Niesterylny przyrząd w opakowaniu typu blister po 6 sztuk (różne lub pojedyncze rozmiary).

Zalecane postępowanie

Protokół operacyjny:

- Stosować w każdej kątnicy prostej do poszerzenia części koronowej kanału w celu masywnego usunięcia struktury.
- Podczas sekwencji endodontycznej wielokrotnie irygować podchlorynem (Endo Clor) i E.D.T.A. (Canal Prep) w celu usunięcia wszystkich tkanek martwiczych i organicznego składnika zawiesiny żebiniowej.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła.

Środki ostrożności

Przed użyciem zaleca się sprawdzenie u pacjentów, czy nie występuje uczulenie na surowce.

Zaleca się, aby zawsze używać rękawic chirurgicznych dla ochrony osobistej przed skażeniem bakteryjnym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zakażenie krzyżowe.


Ostrzeżenia

- Wyrób jednorazowy, ponowne użycie nie jest zalecane w celu ograniczenia problemów z zakażeniem krzyżowym i/lub pęknięciem.
- Nie należy używać blistra, jeśli został otwarty lub uszkodzony.
- Nigdy nie wprowadzać instrumentu do kanału na siłę.
- Nie używać po wskazanej dacie ważności.
- Wszelkie poważne incydenty związane z dostarczonym wyrobem medycznym należy zgłaszać do producenta oraz do właściwego organu w danym państwie członkowskim.

Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów ze znaną wrażliwością alergiczną na surowce.

Symbole

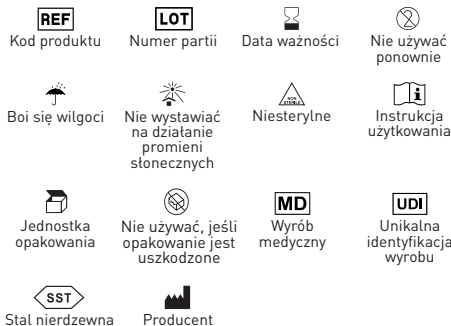

Gwarancja

Dental World wymieni produkt, jeśli okaże się on wadliwy.

Dental World nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z nieostrożnego użycia lub niemożności użycia opisanego produktu. Przed użyciem użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do jego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nieostrożne użytkowanie.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

PT - Largo & Gates

Instrumentos mecânicos de canal radicular

Descrição

Largo & Gates são brocas de aço inoxidável para canais radiculares.

Indicações

Apenas para ser utilizado em consultórios dentários ou em hospitais por pessoal qualificado.

Campo de aplicação

Para aumentar os canais radiculares.

Medidas

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Sor. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Sor. n°1 - 6	144910007	144910014

Embalagem

Dispositivo não estéril em embalagem blister de 6 peças (tamanhos variados ou individuais).

Procedimento recomendado

Protocolo de funcionamento:

- Utilizar em qualquer peça de mão de ângulo recto para alargar a porção coronal do canal para o remoção maciça da estrutura.
- Durante a sequência endodôntica, irrigar repetidamente com hipoclorito (Endo Clor) e E.D.T.A. (Canal Prep) para remover todo o tecido necrótico e o componente orgânico do chorume dentinário.

Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, longe da humidade e da luz directa.

Precauções

Antes da utilização, recomenda-se verificar com os doentes se existe alguma alergia às matérias-primas. Recomenda-se a utilização de luvas cirúrgicas para protecção pessoal contra a contaminação bacteriana. Não o fazer pode resultar em infecção cruzada.


Avisos

- Dispositivo de utilização única, a reutilização não é recomendada para limitar problemas de infecção cruzada e/ou quebra.
- Não utilizar a bolha se aberta ou danificada.
- Nunca forçar o instrumento a entrar no canal.
- Não utilizar após a data de validade indicada.
- Deve comunicar ao fabricante e à autoridade competente do seu Estado Membro quaisquer incidentes graves ocorridos em relação ao dispositivo médico que forneceu.

Contra-indicações

Não utilizar em doentes com sensibilidade alérgica conhecida às matérias-primas.

Símbolos

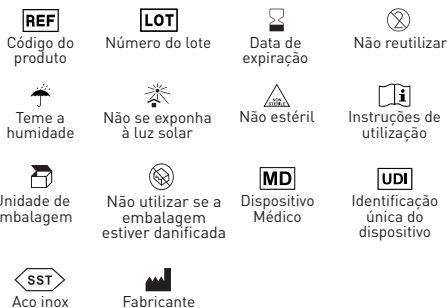

Garantia

Dental World substituirá o produto se este se revelar defeituoso.

Dental World não aceita responsabilidade por qualquer dano ou perda directa ou consequente resultante de utilização descuidada ou incapacidade de utilizar o produto descrito. Antes da utilização, é da responsabilidade do utilizador para determinar a adequação do produto à sua utilização. O utilizador assume a responsabilidade pela utilização uso descuidado.

Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

RO - Largo & Gates

Instrumente mecanice pentru canalul radicular

Descriere

Largo & Gates sunt freze din oțel inoxidabil pentru canale radiculare.

Indicații

A se utiliza numai într-un cabinet stomatologic sau într-un mediu spitalicesc de către personal calificat.

Domeniu de aplicare

Pentru lărgirea canalelor radiculare.

Măsuri

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Aso. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Aso. n°1 - 6	144910007	144910014

Ambalaj

Dispozitiv nesteril în blister de 6 bucăți (mărimi assortate sau individuale)

Procedura recomandată

Protocol de operare:

- Se utilizează în orice piesă de mână cu unghi drept pentru a lărgi porțiunea coronară a canalului pentru îndepărtarea masivă a structurii.
- În timpul secvenței endodontice, irigați în mod repetat cu hipoclorit (Endo Clor) și E.D.T.A. (Canal Prep) pentru a îndepărta toate țesuturile necrotice și componenta organică a suspensiei dentinare.

Depozitare

A se păstra la temperatura camerei, ferit de umiditate și lumină directă.

Precauții

Înainte de utilizare, se recomandă să se verifice la

pacienți dacă există vreo alergie la materiile prime. Se recomandă să se utilizeze întotdeauna mănuși chirurgicale pentru protecție personală împotriva contaminării bacteriene. Nerespectarea acestui lucru poate duce la infecții încrucișate.


Avertismente

- Dispozitiv de unică folosință, nu se recomandă reutilizarea pentru a limita problemele de infecție încrucișată și/sau rupere.
- Nu utilizați blisterul dacă este deschis sau deteriorat.
- Nu forțați niciodată instrumentul în canal.
- Nu utilizați după data de expirare indicată.
- Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul dumneavoastră membru orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul medical pe care l-ați furnizat.

Contraindicații

Nu utilizați la pacienții cu sensibilitate alergică cunoscută la materiile prime.

Simboluri

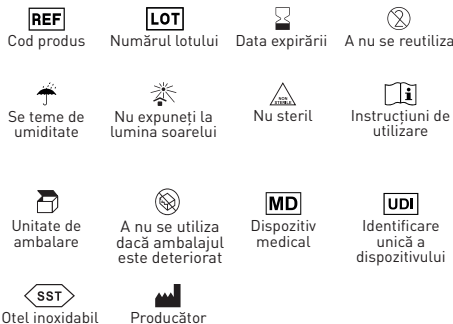

Garanție

Dental World va înlocui produsul în cazul în care acesta se dovedește a fi defect.

Dental World nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau pierderi, directe sau indirecte, care rezultă din utilizarea neglijentă sau din incapacitatea de a utiliza produsul descris. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat pentru utilizarea sa. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru utilizarea neglijentă.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Motfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

SV - Largo & Gates

Mekaniska rotfyllningsinstrument

Beskrivning

Largo & Gates är borrar av rostfritt stål för rotkanaler.

Indikationer

Får endast användas av kvalificerad personal på tandläkarmottagningar eller sjukhus.

Användningsområde

För utvidgning av rotkanaler.

Mått

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Sor. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Sor. n°1 - 6	144910007	144910014

Förpackning

Icke-steril anordning i blisterförpackning med 6 stycken (sorterade eller individuella storlekar).

Rekommenderat förfarande

Operationsprotokoll:

- Används i alla högvinkelhandstycken för att vidga den koronala delen av kanalen för massiv avlägsnande av struktur.
- Under den endodontiska sekvensen, spola upprepade gånger med hypoklorit (Endo Clor) och E.D.T.A. (Canal Prep) för att avlägsna all nekrotisk vävnad och den organiska komponenten i dentinallergin.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur, borta från fukt och direkt ljus.

Försiktighetsåtgärder

Före användning rekommenderas att kontrollera med patienterna om det finns någon allergi mot råvaror. Det rekommenderas att alltid använda kirurgiska

handskar för personligt skydd mot bakteriell kontaminering. Underlåtenhet att göra detta kan leda till korskontaminering.


Varningar

- Engångsutrustning, återanvändning rekommenderas inte för att begränsa problem med korsinfektion och/eller brott.
- Använd inte blistern om den är öppnad eller skadad.
- Tvinga aldrig in instrumentet i kanalen med våld.
- Använd inte efter det angivna utgångsdatumet.
- Du måste rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den medicintekniska produkt som du har levererat till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i din medlemsstat.

Kontraindikationer

Använd inte till patienter med känd allergisk känslighet för råvaror.

Symboler

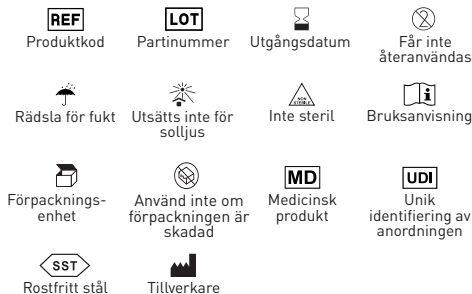

Garanti

Dental World ska ersätta produkten om den visar sig vara defekt.

Dental World tar inte ansvar för skador eller förluster, direkta eller indirekta, som beror på vårdslös användning eller oförmåga att använda den beskrivna produkten. Före användning är det användarens ansvar att avgöra om produkten är lämplig för sitt användningsområde. Användaren tar på sig ansvaret för vårdslös användning.

 Dental World S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)
Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617
e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it